

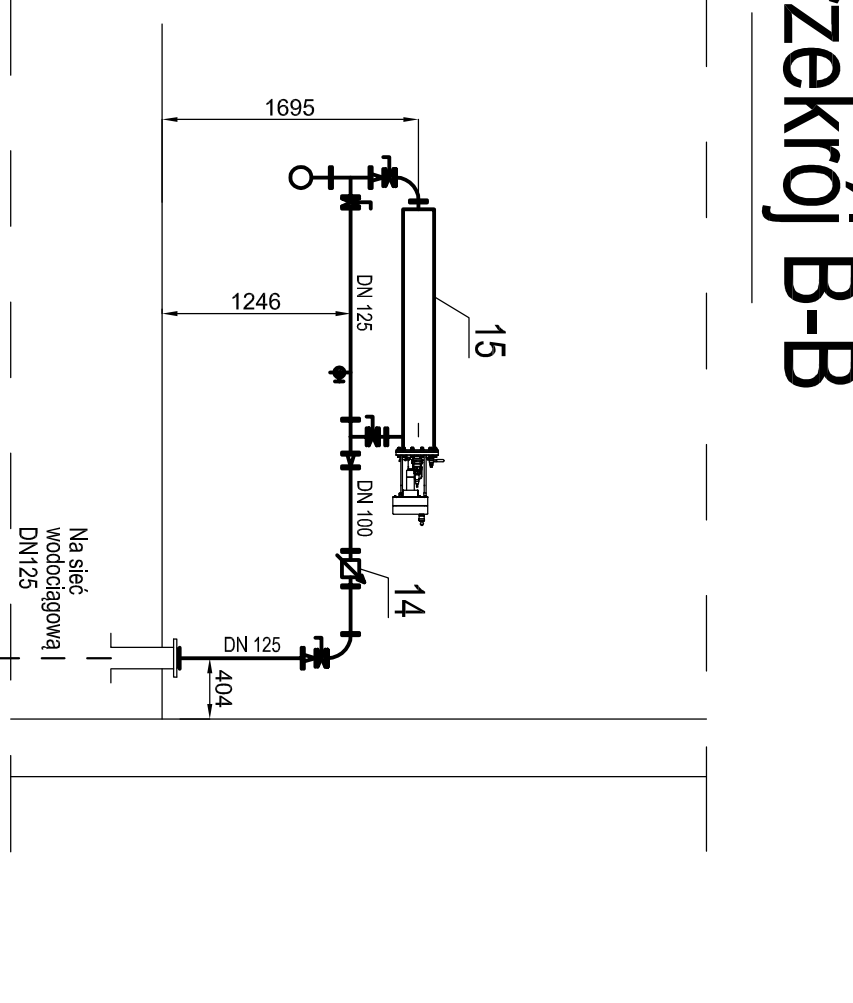



Przekrój A-A

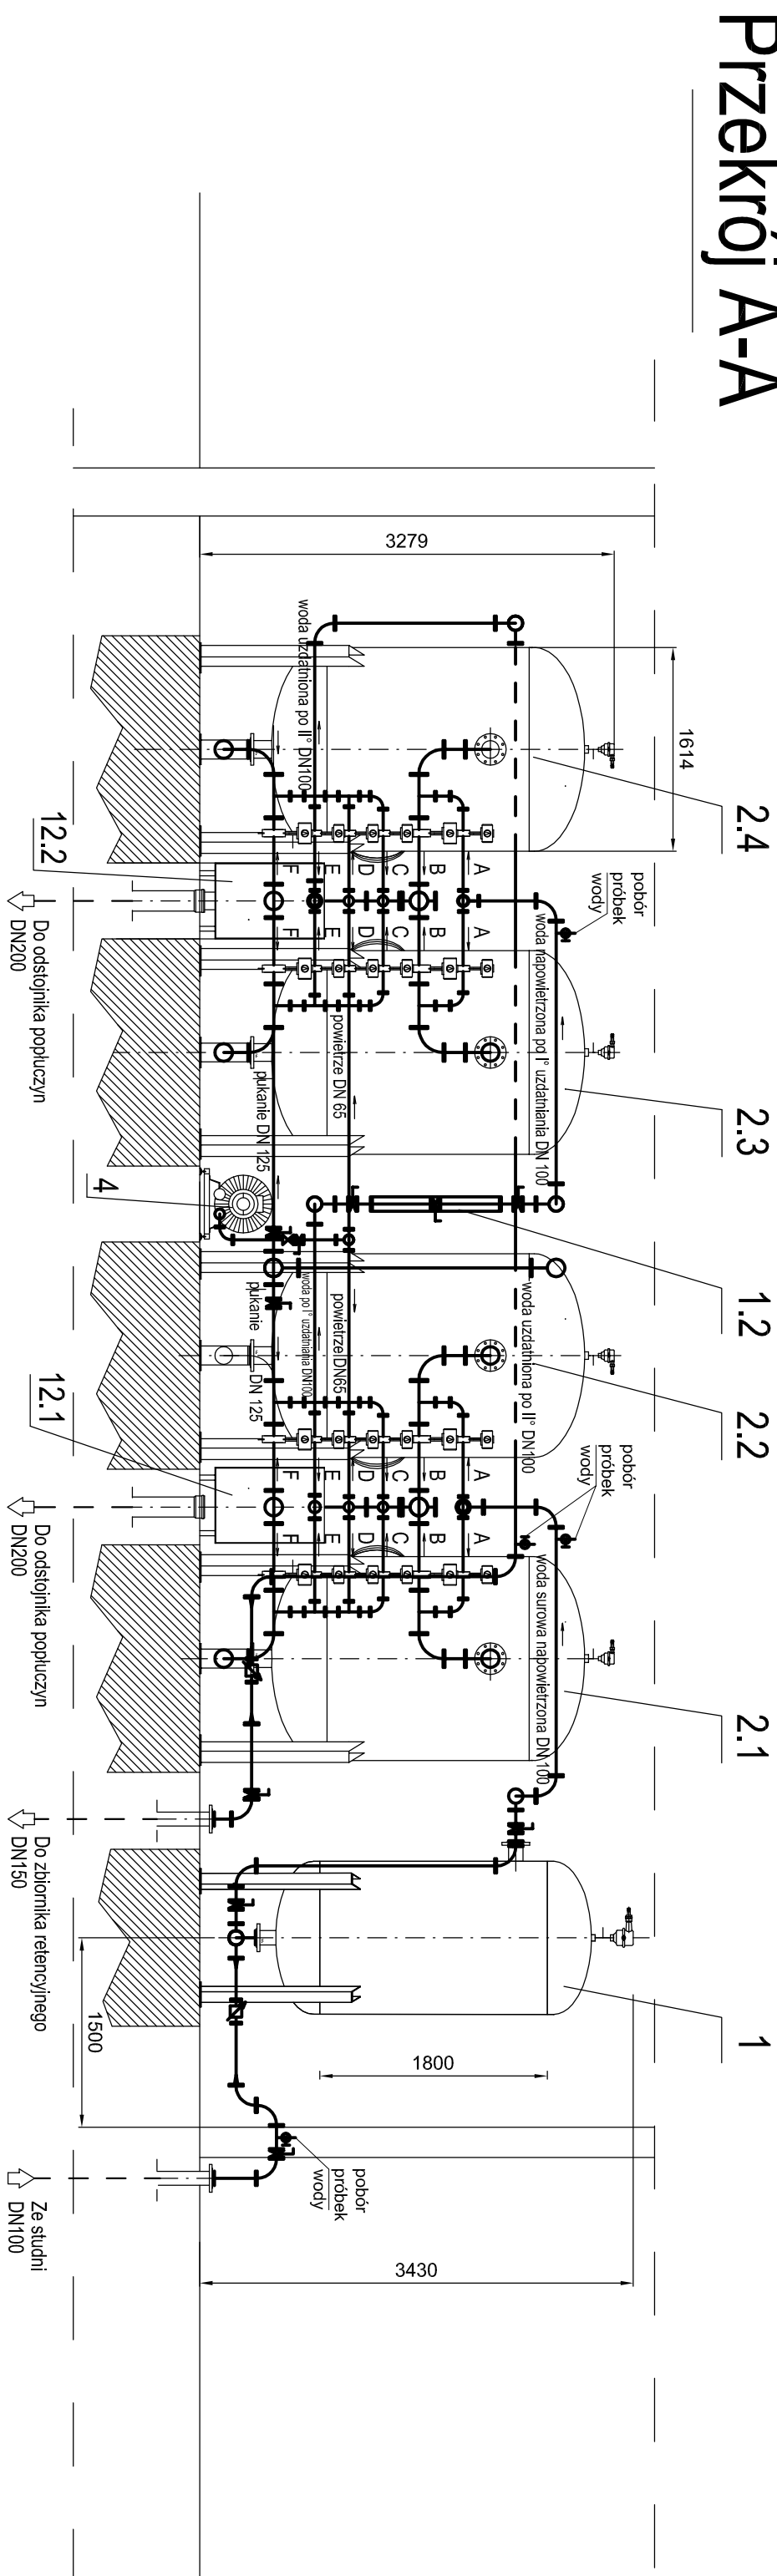

Przekrój B-B

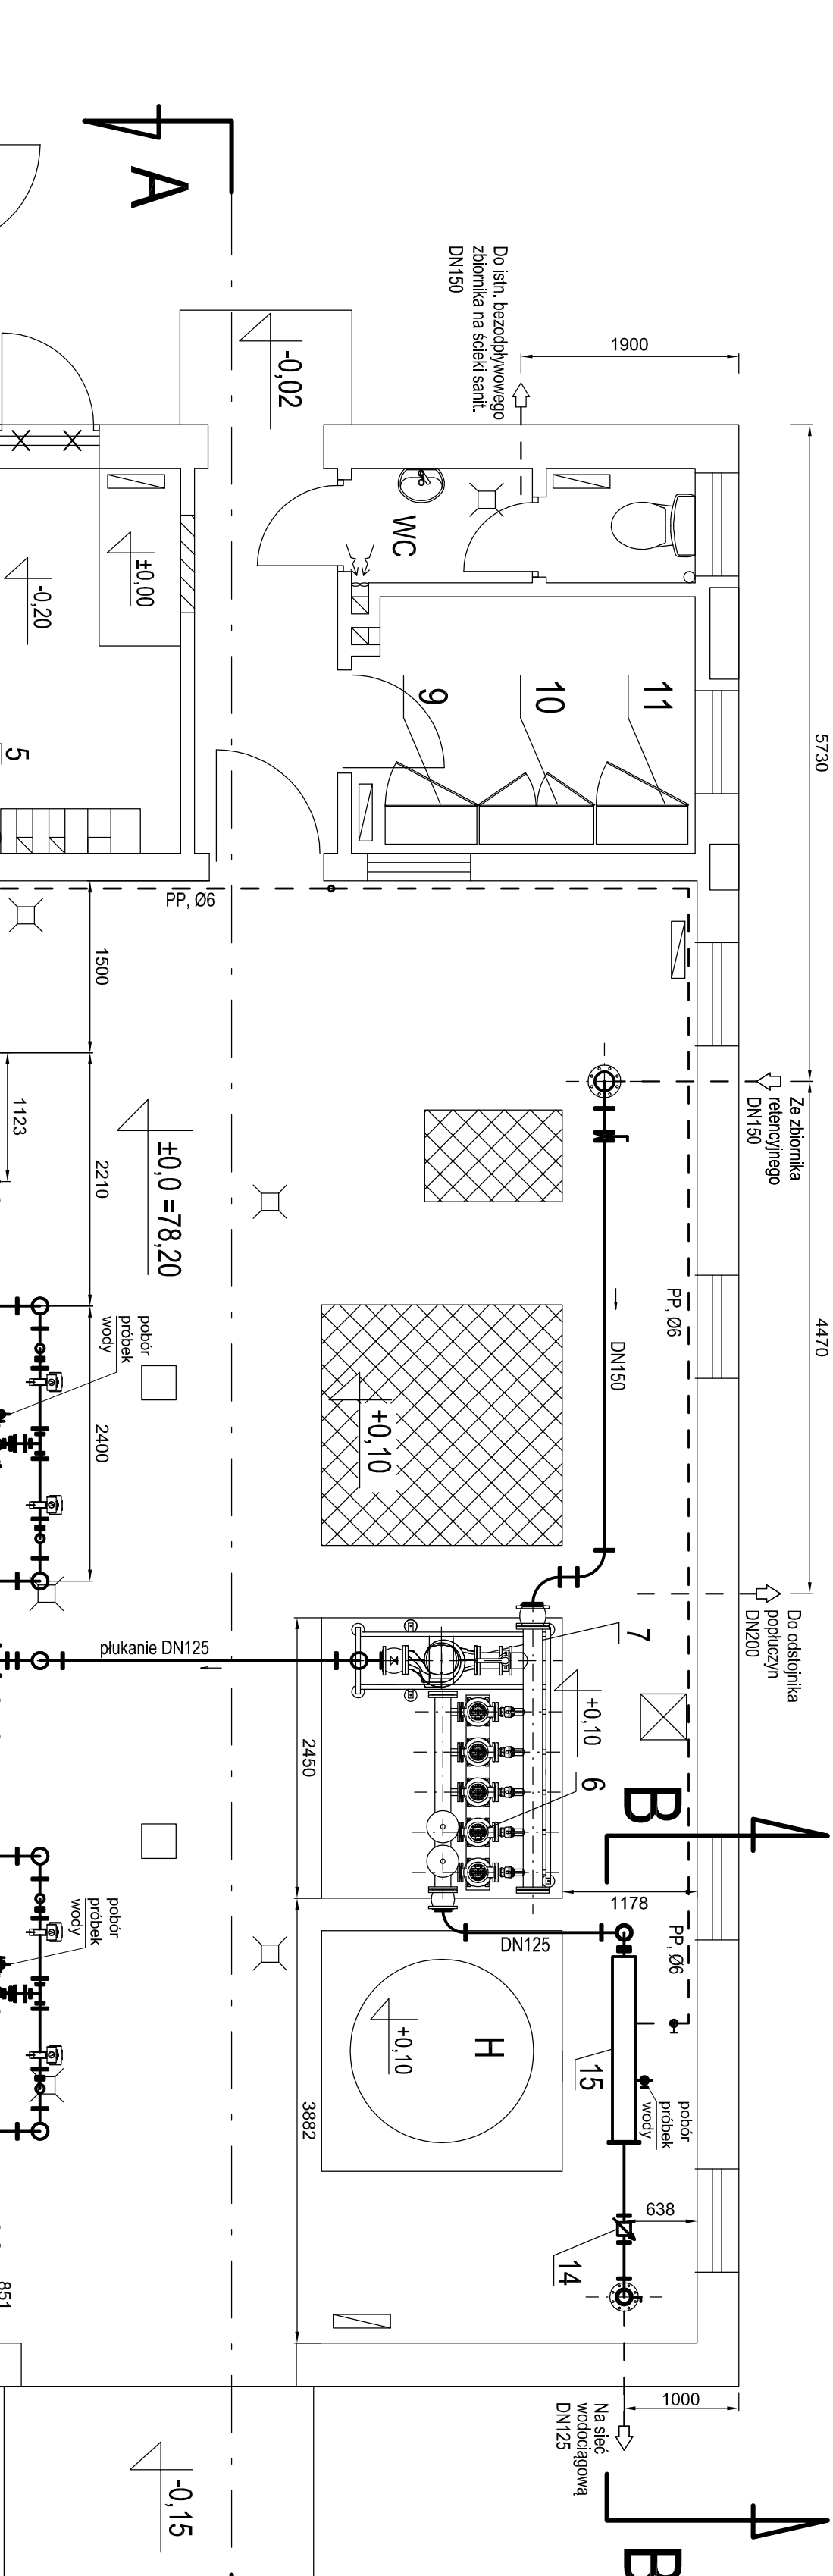

H	Istniejący hydrofor
15.	Lampa UV Spektrom 50e DN 100 ANSI 4-U-78214-2
14..	Przepływomierz elektromagnetyczny SIEMENS DN100
13.	Przepływomierz elektromagnetyczny SIEMENS DN80
12.	Zbiornik kontrolno-pomiarowy
11.	Rozdzielnia główna
10.	Rozdzielnia technologiczna
9.	Rozdzielnia zestawu hydroforowego
8.	Rozdzielnia pneumatyczna
7.	Pompa płuczna TP 125-130/4/5,5kW
6.	Zestaw hydroforowy ZH-ICLMP 5.15.5/ 5.5 kW
5.	Zestaw chloratora
4.	Zestaw dmuchawy DIC-83H K 08R MD
3	Zestaw sprężarki KCT401-250ST
2.3;2.4	Zestaw filtracyjny FIC/106/6;126
2.1;2.2	Zestaw filtracyjny FIC/106/6;126
1.2.	Mieszacz statyczny DN100 L=1000
1.1	Mieszacz statyczny DN100 L=1000
1.	Zestaw aeracji AIC 1200
Lp.	Element

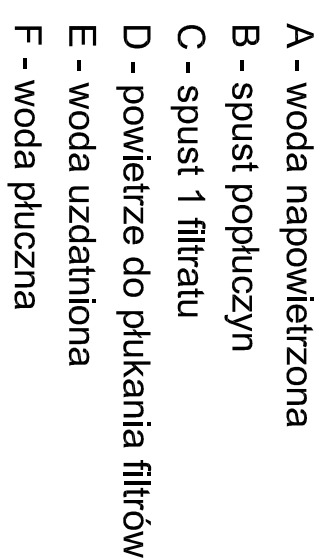[illegible]